



bondimed



**WERDEN
SIE ELITE-
ANBIETER**

Die fortschrittlichste
Schweiß- und
Geruchsbehandlung
auf dem Markt.

Unerfüllte Patientenbedürfnisse bestehen in übermäßigem Schweiß und Geruch

ÜBERMÄSSIGER SCHWEISS UND GERUCH BEEINTRÄCHTIGEN DAS LEBEN DER PATIENTEN SOWOHL PHYSISCH ALS AUCH PSYCHISCH.


ÜBERMÄSSIGER SCHWEISS

Hyperhidrose betrifft weltweit fast 9 % der jungen Erwachsenen und Erwachsenen mittleren Alters.

Hyperhidrose nach Altersgruppe: USA¹

| Alter | Anteil der Betroffenen |
|--------------|------------------------|
| Alle | 4,8 % |
| < 18 | 2,1 % |
| 18–39 | 8,8 % |
| 40–64 | 4,2 % |
| 65+ | 2,1 % |

Die am häufigsten von Hyperhidrose betroffenen Bereiche sind: Achseln¹

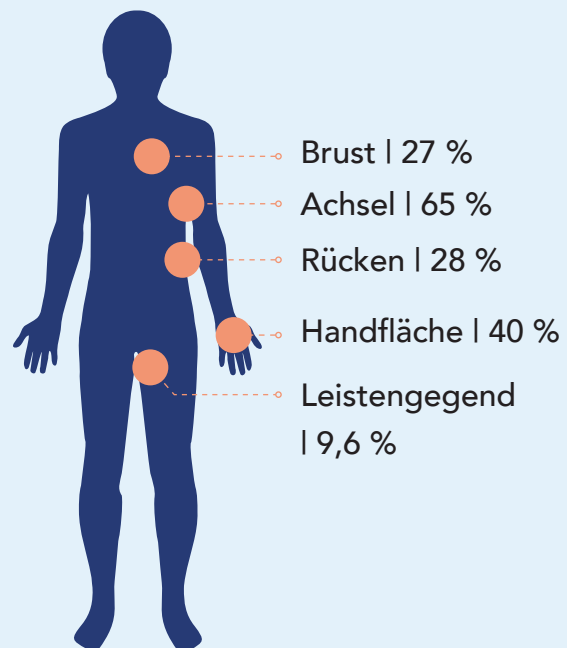

Die Vorteile von miraDry® in Ihrer Praxis



Das miraDry®-Verfahren ist in nur 1 Stunde abgeschlossen und delegierbar⁴



Über 1.600 € Gewinn pro Behandlung⁵

68 %

68 % der miraDry®-Patienten besuchen Ihre Praxis erstmalig¹³

77 %

77 % der Patienten, die nicht-chirurgische kosmetische Behandlungen durchführen lassen, kehren zurück⁶

So wecken Sie das Interesse Ihrer Patienten



Nicht-chirurgisches
Verfahren



FDA-Zulassung zur
Schweißbehandlung und
Geruchsreduzierung



Dauerhaft



Einzigartige, oft unbekannte
Lösung gegen Schwitzen



Optimale Ergebnisse in
1–2 Behandlungen

Ein hervorragendes Behandlungserlebnis für Patienten mit übermäßigem Achselweiß



Konsole

- Einfach zu bedienendes Behandlungssystem mit großen, leicht lesbaren Symbolen.
- 360°-Touchscreen – Rundumsicht.
- 110 V, Standard für jede Praxis (100–240 V, 50/60 Hz).



Handstück


- Mittels Saugkraft wird die Haut von tieferen Schichten weggezogen, während die Kühlplatte für maximalen Komfort sorgt.
- Die Kühlplatte schützt die Hautoberfläche, wodurch die Behandlung für den Patienten angenehmer wird.
- Akustische und gut sichtbare Symbole geben Feedback während des Aufheizens und Abkühlens.
- Leicht zu greifen und während der Behandlung zu steuern.
- Liegt sicher im Systemholster, wenn es nicht benutzt wird.



Einweg-bioTip™


- Stabilisiert das Gewebe und lässt Energie ungehindert durchfließen.
- Problemlose Reinigung und einmalige Verwendung für mehr Sicherheit im Behandlungsbereich.
- Haftet leicht am Handstück dank magnetischer Oberfläche.

Das erste und einzige von der FDA zugelassene Gerät, das Wärmeenergie nutzt, um Schweiß an der Quelle dauerhaft zu reduzieren

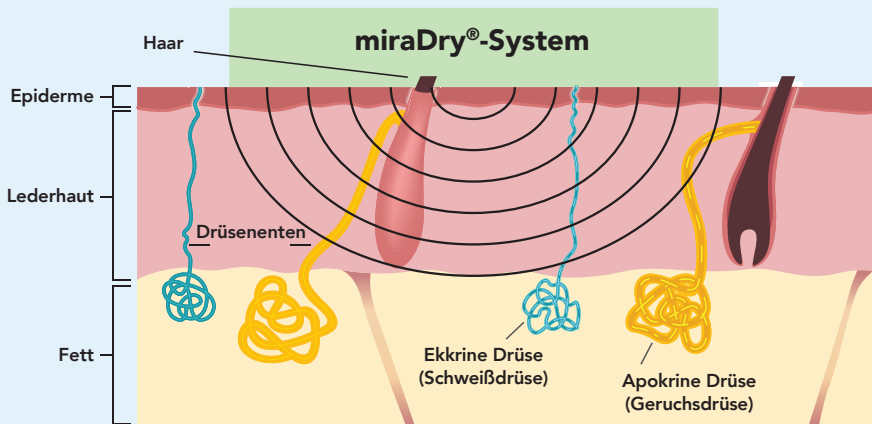


Proprietäres System

Fokussierte Energieabgabe an den Bereich zwischen Haut- und Fettschicht

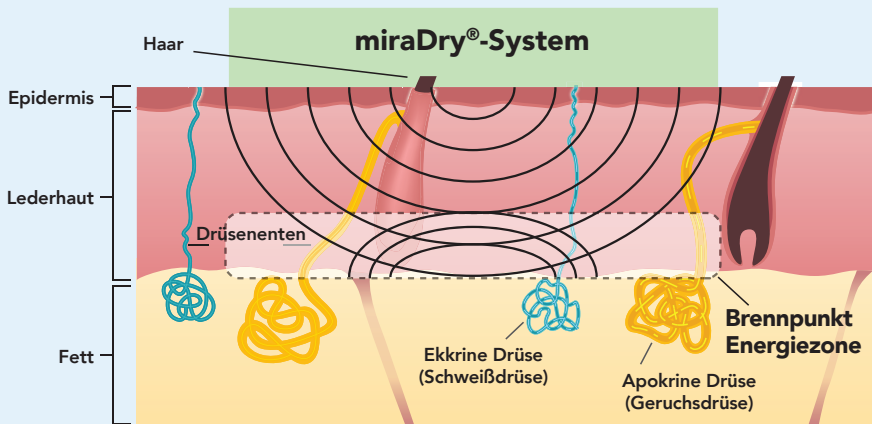

Fokale Energiezone

Die Energie konzentriert sich entlang dieser Schicht und erzeugt eine fokale Energiezone

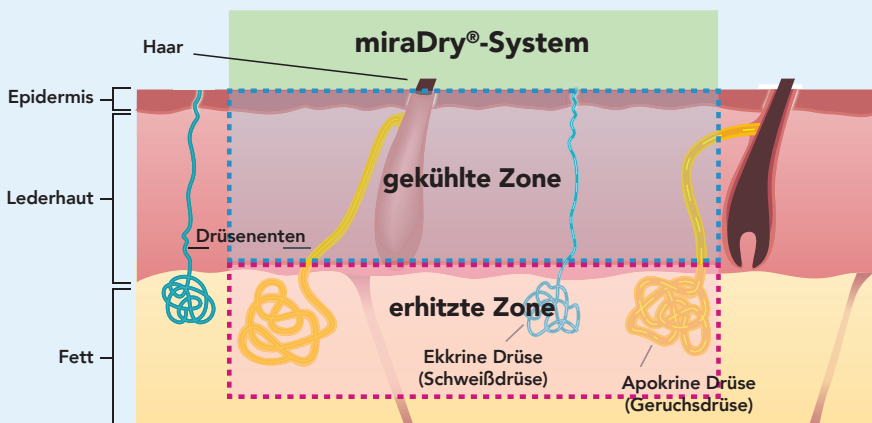

Hydra-Keramik-Kühlung

Die kontinuierliche Hydra-Keramik-Kühlung hält die Hautoberfläche kühl, während Wärmeenergie an die Schweißdrüsen abgegeben wird

Das ideale Ergebnis? Kein Schwitzen.



Vorbereitung

- Verstehen Sie die Ziele der Patienten zur Schweiß- und Geruchsreduzierung.
- Klären Sie die Erwartungen für die erste und, falls erforderlich, zweite Behandlung.
- Gehen Sie die Vorbereitung vor dem Eingriff durch und senden Sie entsprechende Anweisungen per E-Mail oder stellen Sie diese in Papierform zur Verfügung.



Die Behandlung

- Führen Sie die Anästhesie zum Wohle des Patienten angemessen durch.
- Konzentrieren Sie sich auf den Patienten und sorgen Sie dafür, dass er sich entspannt.



Nachsorge

- Gehen Sie die Anweisungen für die Zeit nach dem Eingriff mit dem Patienten durch.
- Besprechen Sie häufige und seltene Nebenwirkungen.



Follow-up

- Melden Sie sich 24 Stunden nach der Behandlung bei dem Patienten, um ihn an die Nachsorge zu erinnern.
- Vereinbaren Sie proaktiv einen Nachsorgetermin in 90 Tagen.
- Besprechen Sie, ob nach dem Stärke-Jod-Test eine zweite Behandlung erforderlich ist.

3 SCHRITTE ZU WENIGER SCHWEISS



Eine lokale Betäubung sorgt für maximalen Komfort während der Behandlung.





Ein temporäres Tattoo kennzeichnet die Haut zur Vorbereitung auf die Behandlung.



Der Bereich wird mit miraDry® behandelt, um Schweiß- und Geruchsdrüsen unter der Achsel zu beseitigen.

miraDry® – eine bewährte Schweiß- und Geruchslösung

BEHANDELN SIE DIE URSACHE, NICHT DIE SYMPTOME

| |  |  |
|---|--|--|
| Wirksamkeit | Dauerhaft nach 1–2 Behandlungen, Schweiß, Geruch, Haare | Dauer von 3–9 Monaten, nur Schweiß |
| Sicherheit | Minimale bis keine Ausfallzeiten, lokale Schwellung, Schmerzen | Minimale bis keine Ausfallzeiten, lokale Schwellung, Schmerzen |
| Wert für die Praxis | Über 1.500 € Gewinn ⁸ | 600 € Gewinn ⁸ pro Behandlung, bei Barzahlung |
| Patient Adhärenz und Zufriedenheit | Hohe Zufriedenheit mit einer Behandlung, optimale Ergebnisse nach 2 Behandlungen | Nur 44 % lassen mehr als eine Behandlung durchführen |
| MOA | Beseitigt Schweißdrüsen dauerhaft mit Mikrowellenenergie. Dauerhafte Reduzierung von Schweiß, Geruch und Haaren. | Blockiert Schweißdrüsen vorübergehend. Vorübergehende Reduzierung von Schweiß und Geruch (6–9 Monate). |
| Kosten für Patienten | €€ | €€€ |



Schon gewusst?

Patienten, die bereits eine Botoxbehandlung hinter sich haben, fragen fünfmal wahrscheinlicher nach miraDry®.²

Generieren Sie mit miraDry® mehr Umsatz in Ihrer Praxis

4X

Mit miraDry® können Sie im Vergleich zu Botoxbehandlungen in 12 Monaten viermal mehr Umsatz pro Patient generieren.¹³



Im Gegensatz zu alternativen Behandlungen ist die miraDry®-Compliance hoch und benötigt nur 1–2 Behandlungen mit hoher Patientenzufriedenheit.

UMSATZMÖGLICHKEIT

| miraDry®-Umsatz pro Patient | | Behandlungen/Monat | Jährlicher Umsatz durch miraDry® |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Einnahmen insgesamt | 2.000 €¹¹ | 25 | 600.000 € |
| | | 20 | 480.000 € |
| | | 15 | 360.000 € |
| | | 12 | 288.000 € |
| | | 10 | 240.000 € |



PROFITABEL



ERSCHWINGLICH



EFFEKTIV

Endlich Schluss mit Schweiß und Gerüchen.



miraDry, Inc.

100 Bayview Circle, Suite 360 | Newport Beach, CA 92660

Tel: 408-579-8700

Technischer Support, Vertrieb und Kundenservice:

1-855-miraDry (1-855-647-2379)

corp.miradry.com

**Kontaktieren Sie Ihren Aesthetic Business Manager
und bestellen Sie noch heute.**

Quellen:

1. Global Hyperhidrosis Treatment Market (2022–2027) [Globaler Markt für Hyperhidrose-Behandlungen (2022-2027)], Mordor Intelligence 2021
2. CARAVAN® Omnibus-Befragung, miraDry, 2022
3. International Hyperhidrosis Society, sweathelp.org
4. Die Behandlung ist innerhalb einer Stunde nach der Betäubung abgeschlossen.
5. Basierend auf Patientenkosten in Höhe von 2.000 € und einem Kaufpreis pro bioTip™ von 399 €.
6. Plastic Surgery Statistics Report, 2020.
7. Klinische Studie: CP0005, Fotos mit freundlicher Genehmigung von Nobuharu Kushikata, Tokio, Japan, Publikationsquelle: Expression of Human Eccrine Sweat Glands, *Journal of Cutaneous Pathology*
8. Basierend auf den durchschnittlich gemeldeten Behandlungskosten. Vorliegende Daten.
9. Marwan W. Nasr, Samer F. Jabbour, Roger N. Haber, Elio G. Kechichian & Lena El Hachem (2017) Comparison of microwave ablation, botulinum toxin injection, and liposuction-curettage in the treatment of axillary hyperhidrosis: A systematic review, *Journal of Cosmetic and Laser Therapy*.
10. Ergebnisse basierend auf zwei Behandlungen.
11. Berechnung basierend auf 1 Behandlung pro Patient zum landesweit durchschnittlichen Behandlungspreis von 2.000 €
12. A. Svensson, R.F. Ofenloch, M. Bruze, L. Naldi, S. Cazzaniga, P. Elsner, M. Goncalo, M.-L.A. Schuttelaar, T.L. Diepgen, *British Journal of Dermatology*, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjd.16248>
13. miraDry® vorliegende Daten

Der empfohlene Behandlungspreis (MSTP) von miraDry® beträgt 2.000 € für eine Behandlung und 3.000 € für zwei. Der MSTP wurde zum Nutzen der Praxen eingeführt, um den Ruf von miraDry® als hochwertiges medizinisches Verfahren zu wahren.

Das miraDry®-System ist von der FDA für die Behandlung der primären axillären Hyperhidrose und die dauerhafte Entfernung von Achselhaaren zugelassen. Es kann auch Achselgeruch reduzieren.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Von der Behandlung mit miraDry® sollte bei Patienten abgesehen werden, denen ein Herzschrittmacher oder ein anderes elektronisches Gerät implantiert wurde, die zusätzlichen Sauerstoff benötigen oder eine bekannte Resistenz oder Unverträglichkeit gegenüber Lokalanästhesie, wie Lidocain und Epinephrin, haben. Zu den häufigsten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit miraDry® gehören Schwellungen, Unwohlsein oder Schmerzen, Rötungen, Blutergüsse, Beulen und eine veränderte Sensibilität im behandelten Bereich. Vor der Verwendung sollten Gesundheitsdienstleister alle Risikoinformationen in der Gebrauchsanweisung lesen. Eine vollständige Gebrauchsanweisung und detaillierte Informationen einschließlich Risiken und Nutzen finden Sie unter corp.miradry.com.

miraDry® und bioTip™ sind Marken von miraDry, Inc. © 2023 miraDry, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. MK22059.A



bondimed

BONDIMED Aesthetics GmbH
Unterthalhamstrasse 2 | A-4694 Ohlsdorf
Tel: +43 7612 204 55
Email: office@bondimed.at



miraDry®

miraDry, Inc.
100 Bayview Circle, Suite 360 | Newport Beach, CA 92660
Tel: 408-579-8700

Technischer Support, Vertrieb und Kundenservice:
1-855-miraDry (1-855-647-2379)
corp.miradry.com